

記載内容の訂正とお詫び（正誤表）

2025年度 日臨技九州支部医学検査学会（第59回）ポケットプログラムにおきまして、掲載内容に誤りがございました。


謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

正誤箇所	誤	正
P3.【学会長挨拶】	本学会のメインとなる一般演題には <u>93題</u> のエントリーをいたしました。	本学会のメインとなる一般演題には <u>92題</u> のエントリーをいたしました。
P9.【3.学会日程表 第2日目】	ランチョン6	ランチョン5
P19.【9.各県別一般演題数および座長数】	熊本県微生物演題数4	熊本県微生物演題数3
P30.【14.抄録目次 一般演題】	7胆管炎の患者の血液培から <i>Streptococcus infantarius subsp. coli</i> を検出した一例	7演題取り下げ
ポケットプログラム全体	国立大学法人 長崎大学病院	長崎大学病院
P25.【12.部門企画一覧】 シンポジウムIII	藤野 恵子 国立大学法人 九州大学病院	藤野 恵子 九州大学病院
P25.【12.部門企画一覧】 シンポジウムIV	河野 克海 国立大学法人 宮崎大学医学部付属病院	河野 克海 宮崎大学医学部附属病院
P26.【12.部門企画一覧】 シンポジウムV	山本 紀子 国立大学法人 熊本大学病院	山本 紀子 熊本大学病院
P26.【12.部門企画一覧】 シンポジウムVI	シンポジウムVI 血液・総合管理・生理・超音波合同 「AIに期待！臨床検査技師の未来～臨床検査業務をAIが変える？～」	シンポジウムVI 血液・総合管理・生理・超音波合同 「臨床検査 × AI ～進化と共に問われる、検査技師の新たな役割～」
P29【13.ランチョンセミナー】 10月19日	藤野 達也 独立行政法人国立病院機構崎医療センター 臨床検査科 技師長	藤野 達也 独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 臨床検査科 技師長

正誤箇所	誤	正
P5.【会場・展示会場・駐車場案内図】	下記図面 左	下記図面 右


2 階

教養文化棟

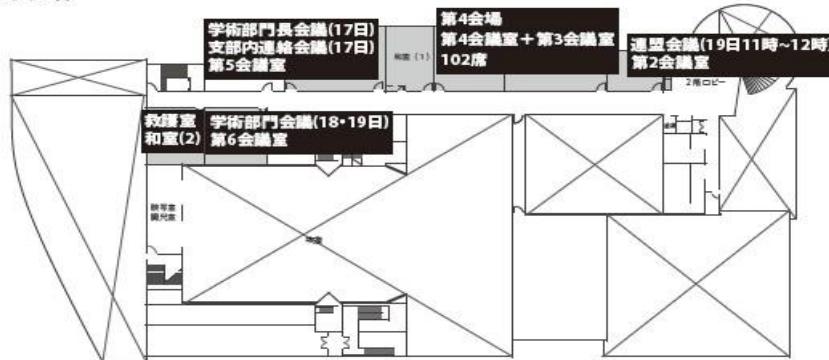


2 隅


教育文化棟

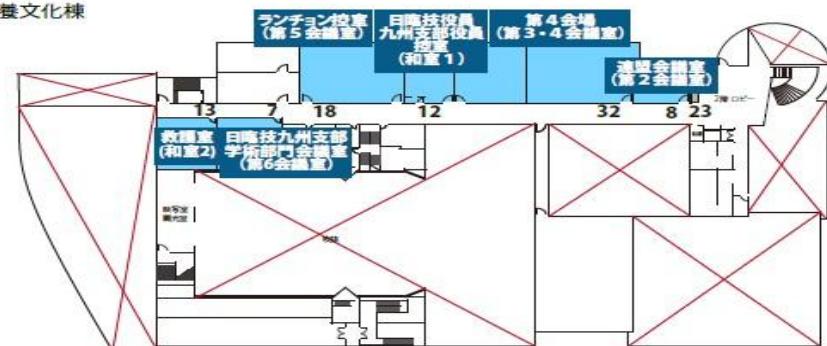

1 階

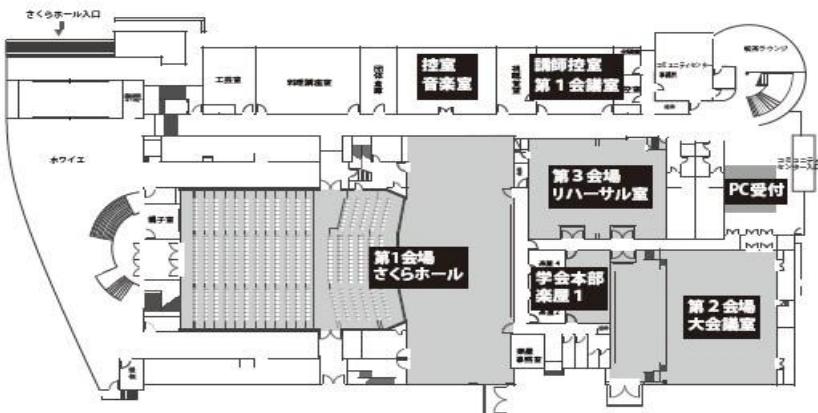


1 階

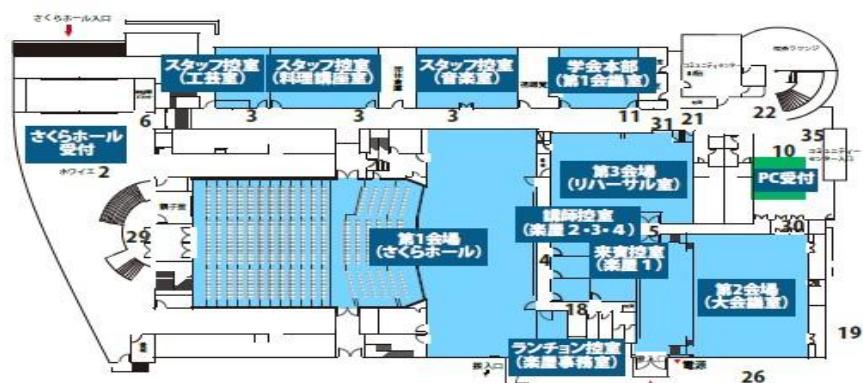


正誤箇所	誤	正
P6.【会場・展示会場・駐車場案内図】	下記図面 左	下記図面 右

スポーツ棟

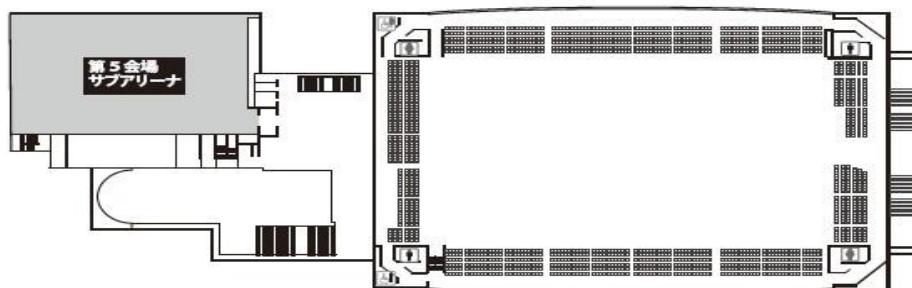

スポーツ棟

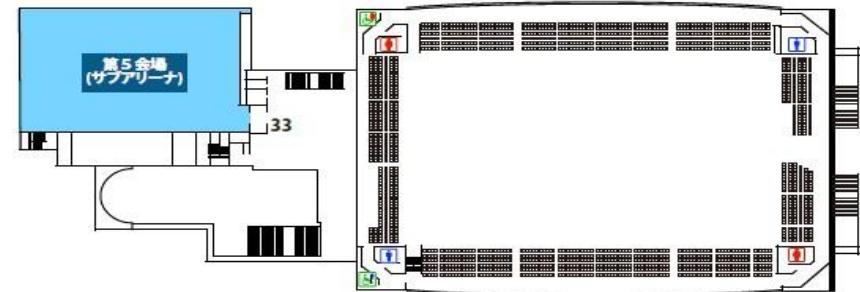

The floor plan illustrates the layout of the exhibition hall. Key areas include:

- お土産品・観光案内** (Souvenir and Tourism Information) located near the center.
- 受付** (Check-in) areas marked with double-headed arrows.
- トレーニングルーム** (Training Room) and **フィットネスホーム** (Fitness Home).
- 記名台** (Registration Desk) and **展示・ドリンク** (Exhibition and Drink) counter.
- テープカット** (Tape Cutting) area.
- ヤマト** (Yamato) and **クローケー** (Cloaker) delivery points.
- 展示会場 メインアリーナ** (Exhibition Hall Main Arena) on the right side.
- Various **休憩室** (Rest Rooms) and **男女共同浴場** (Gender-Neutral Bathrooms) are indicated throughout the building.

正誤箇所	誤	正
P7.【会場・展示会場・駐車場案内図】	下記図面 上	下記図面 下

